OTSC® CLIP

OTSC® System – Montageanleitung / Hinweise

ovesco innovation in scope

1. Komponenten aus dem Blister entnehmen.
2. Handrad auf den Endoskop-Arbeitskanal montieren.
3. Den Klettverschluss des Handrades schließen.
4. Fadenholer durch den Arbeitskanal einführen.
5. Fadenende mit dem Fadenholer greifen. Faden durch den Arbeitskanal ziehen.
6. Faden am Handrad in der Nut fixieren und aufwickeln.
7. Kappe auf das Endoskop montieren.
8. Endoskop bis zur Markierung der Kappe vorschieben! Hilfsmittel: Flüssigkeit z.B. Gel
9. Beim Anbringen der Kappe auf dem Endoskop ist auf die Position des Fadens zu achten. Dieser darf nicht das Sichtfeld behindern.
10. Bei der Einführung eines weiteren Instruments in den Arbeitskanal muss der Faden unter leichter Spannung gehalten werden.
11. Vor dem Clippen ist das Instrument festzuhalten! Um den Clip auszulösen, ist ein zügiges und vollständiges Drehen des Handrades erforderlich!

Scannen Sie den QR Code, um das Aufbau-Video anzusehen.

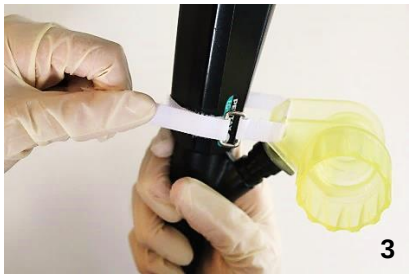

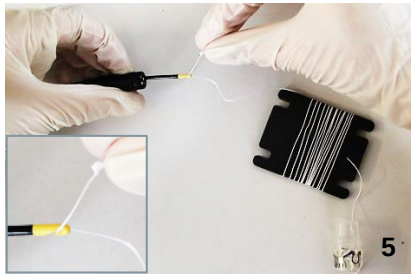

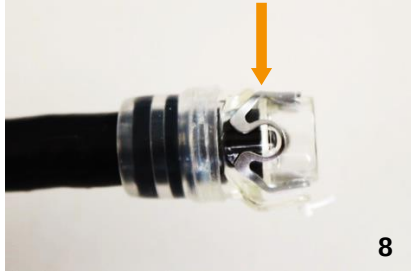

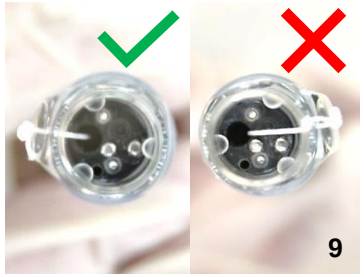

Ovesco Endoscopy AG | Friedrich-Miescher-Str. 9 | 72076 Tübingen | Deutschland | +49 (0)7071 96528-160 | service@ovesco.com | www.ovesco.com

OVE_OTSC System_Infosheet_deu_rev07_2021-04-16

OTSC® System – Montageanleitung / Hinweise

Stellen Sie sicher, dass das Endoskop bis zum Anschlag der Kappe montiert wurde (12 B), um einen sicheren und effektiven Einsatz des OTSC® System zu gewährleisten. Sind die Anschläge im endoskopischen Bild noch zu sehen, ist die Kappe nicht korrekt montiert (12 A).

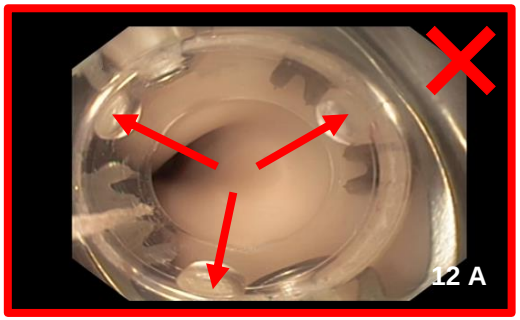

Stellen Sie sicher, dass Instrumente immer bei gestrafftem Faden in den Arbeitskanal eingeführt werden. Bei nicht gestrafftem Faden kann sich dieser während des Einführens um das Instrument wickeln und dadurch die Clipapplikation erschweren (13).

Entfernen Sie ggfs. das Instrument komplett aus dem Arbeitskanal und führen es bei gestrafftem Faden erneut ein. Zur Hilfestellung kann hierbei das Handrad an den Oberkörper (14) gedrückt werden (verhindert Abrollen des Fadens).

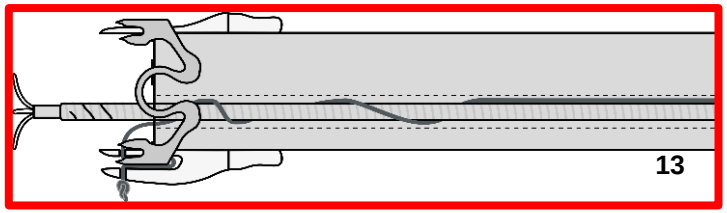
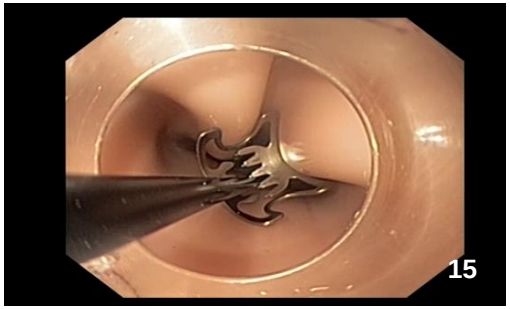
Sollte eine Applikation des OTSC® im OGI nicht möglich sein und der Clip auf der Applikationskappe verbleiben, besteht bei oraler Ausführung des Systems das Risiko der Friktion und ungewollten Applikation des Clips. Hier kann ggfs. der Clip im freien Magenlumen oder auf den durch den Arbeitskanal geführten Fadenholer appliziert und vorsichtig geborgen werden (15).